



ЗАО «МАССА-К»

Утверждаю
Раздел 3 «Методика поверки»
Руководитель ГЦИ СИ
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»




И.И. Ханов

«03» июля 2009 г.

Весы электронные медицинские ВЭМ-150-«Масса-К»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(Тв2.790.065 РЭ)

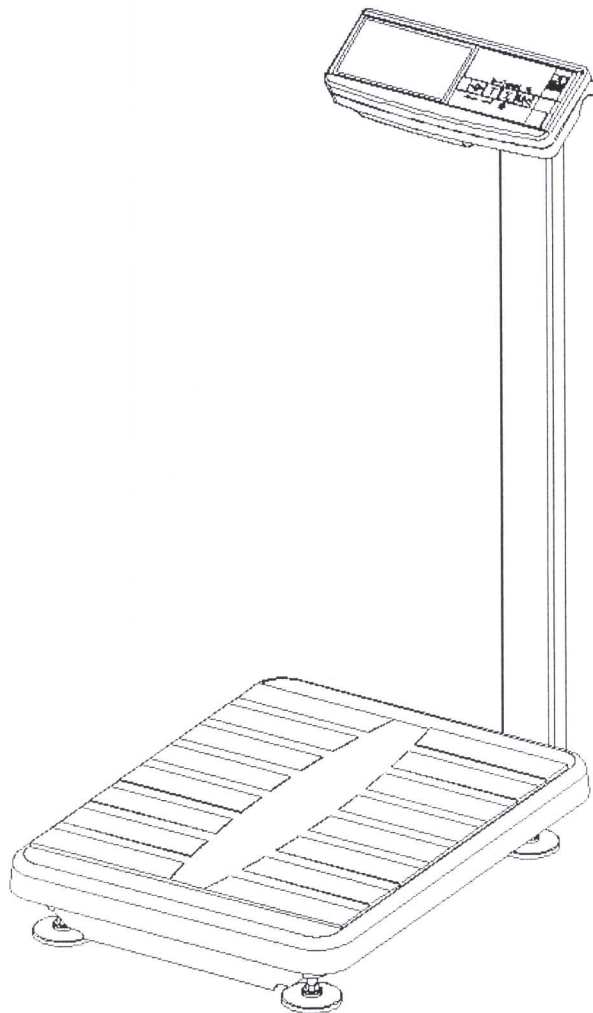

ME01



Прочтите перед эксплуатацией